



LETICIA GUZMÁN CARBAJAL

MEDICO CIRUJANO

CED. PROF. 3912072 U.A.S.L.P. S.S.A 6203-2010 M.C.


CALLE MAGUEY 175-A COL. CASANOVA C.P. 78397



EXAMEN DE ESPIROMETRIA

EMPRESA: PLASTIGAS

NOMBRE: ALMANZA MARTINEZ ALICIA

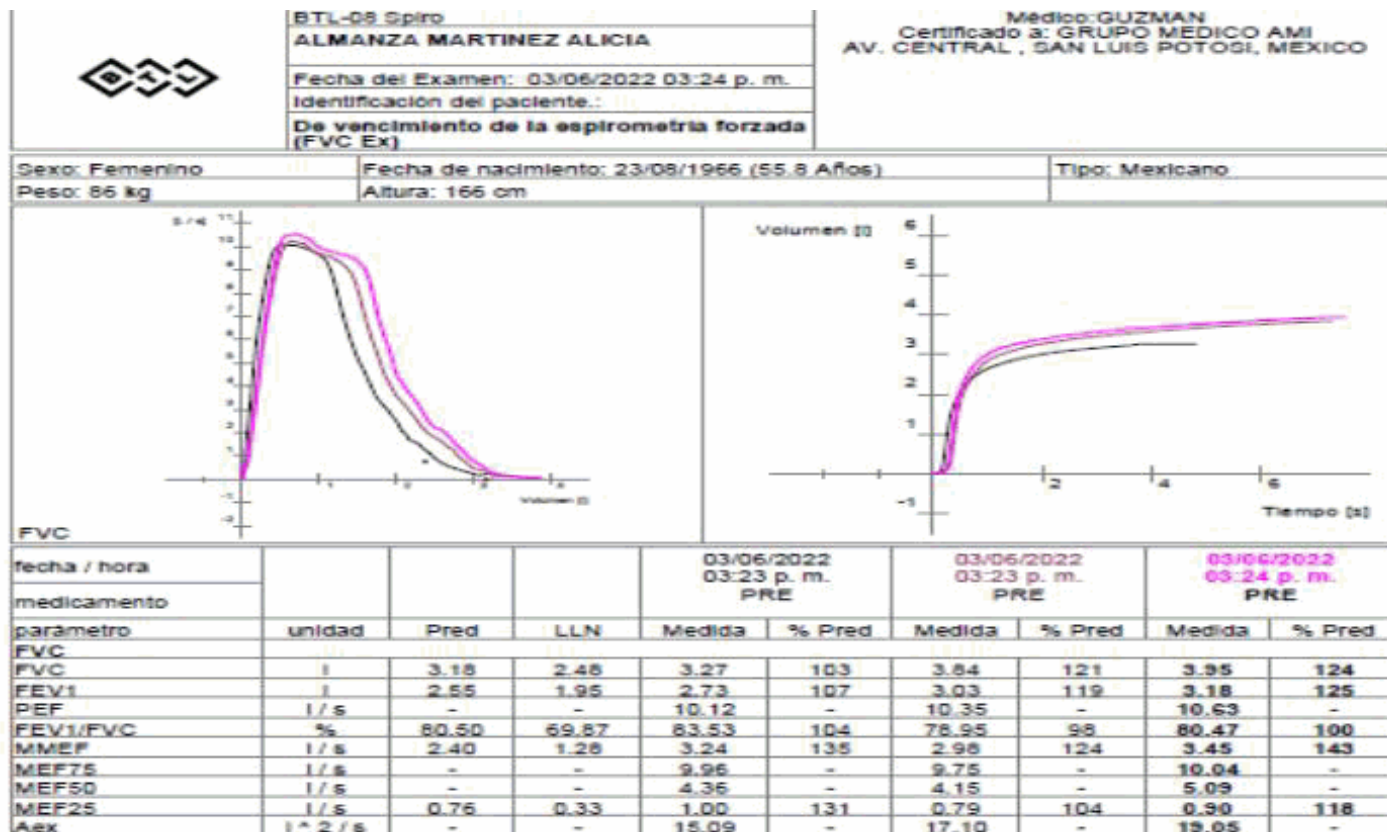

Interpretación ATS: espirometría normal
Predicción: GLI 2012. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.
En la repetición: +FVC +FEV1 -ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.178l +TEX 7.6s -Plateau

Calibración: 02/05/2022 / 003000035511 Firma:
ATP: 25/815/54 [°C/bar/%]
BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag: 9.16.12.26

Impreso: 03/06/2022
Copyright © BTL Industries Ltd. 2017
Licenciado a: GRUPO MEDICO AMI

DX: ESPIROMETRIA DENTRO DE LOS PARAMETROS NORMALES



Leticia Guzman Carbajal
MEDICO CIRUJANO
CED. PROF. 3912072
U.A.S.L.P.
S.S.A 6203-2010 M.C.