



Servicios Integrados para la Industria 10E
Av. Benito Juárez 4055/Int D Villa de Pozos
78421 San Luis Potosí, SLP
México

Somme Santé

NOMBRE:

SALAZAR RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO

FECHA:

11/04/2023 14:58:14

EXAMEN

AUDIOMETRÍA
ESPIROMETRÍA

NORMAL
NORMAL

Dr. Juan Jose Muñoz Sandoval
CED. PROF/ AEP-2372

EXAMEN AUDIOMETRICO



Somme Santé



LEBEN
LABORATORIO

11/04/2023


DATOS

NOMBRE: SALAZAR RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO EDAD: 20 AÑOS SEXO: MASCULINO
EMPRESA: GESTAMP
TIPO DE EXAMEN: PERIODICO

TINITUS: NEGADO USO DE MEDICAMENTOS POR TIEMPO PROLONGADO: NEGADO
CUALES: N/A
MAREO: NEGADO NAUSEA: NEGADO
PASATIEMPOS RUIDOSOS:
EXPLORACION FISICA OIDO EXTERNO: SIN DATOS PATOLOGICOS
EXPLORACION FISICA OIDO INTERNO: SIN DATOS PATOLOGICOS
TIMPANO PERFORADO:

FRECUENCIA

REFERENCIA		
Oído	Ósea	Resp.
Der	]	▲○
IZQ	[	▼▲

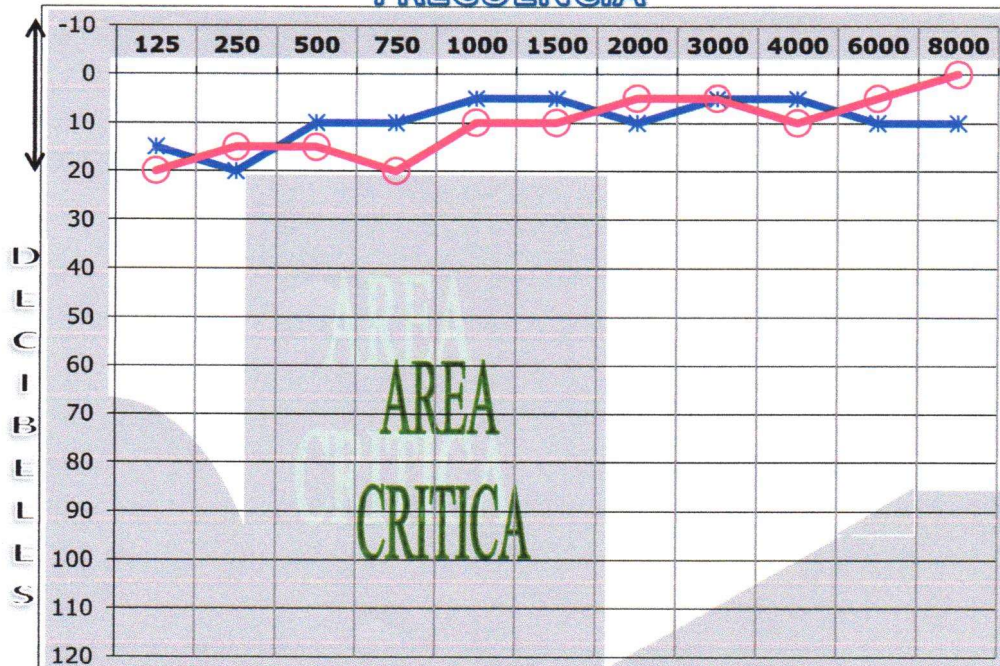

DIAGNOSTICO: AUDIOMETRIA DENTRO DE LOS PARAMETROS NORMALES

Dra. Carolina Rivera Urenda

CAOHC: 511455



Resultados de la prueba de Función Pulmonar



Somme Santé **LEBEN**
LABORATORIO

Fecha de visita 11/04/2023

Cód. paciente	WSP7579229474	Edad	20
Apellido	SALAZAR RODRIGUEZ	Género	Masculino
Nom.	DIEGO ARMANDO	Altura, cm	170
Fecha de nacimiento	05/05/2002	Peso, kg	61
Grupo étnico	Caucásico	BMI	21.11
Fuma	No fumador	Paquete-año	
Grupo pacientes			

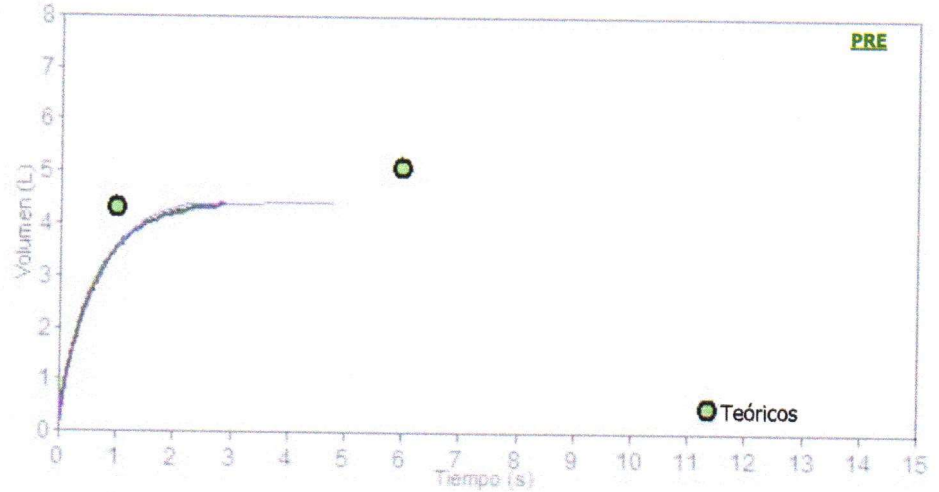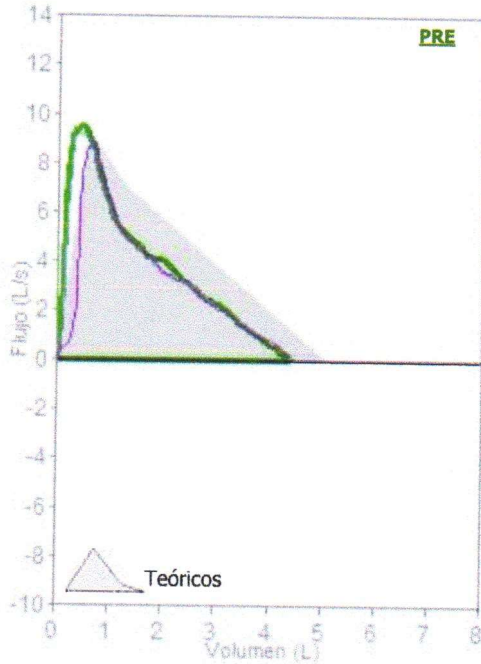

Grado de control de calidad: A Variabilidad: FEV1=0.01L (0.28%), FVC=0.12L (2.8%)
3 Acceptable trials

Interpretación

Espirometría normal

Fecha prueba PRE 11/04/2023 08:24:49 a. m.

Parámetros	LLN	Teór.	Best	%Teór.	Z-score	PRE #1	PRE #2	PRE #3	POST	%Teór.	%Cam
FVC L	4.25	5.10	4.41*	86	-1.33	4.25	4.29	4.40	*		
FEV1 L	3.58	4.30	3.59*	84	-2.01	3.48	3.54	3.59	*		
FEV1/FVC %	74.3	83.9	81.4*	97	-0.43	81.9	82.5	81.6	*		
PEF L/s	7.28	9.40	9.78*	104	0.30	9.37	9.78	9.52	*		
ELA años		20									
FEF2575 L/s	3.23	4.69	3.28	70	-1.61	3.16	3.25	3.28			
FET s		6.00	2.84	47		3.02	2.75	2.84			
EVol mL			91			32	57	91			
FIVC L	4.25	5.10									
FEV1/VC %	74.3	83.9									

*Mejores valores de todas las curvas - BTPS 1.097 24 °C (75.2 °F) - Teóricos NHANES III

Informe médico

Firma

Instrumento usado
Spirobank II new S/N Y07245